

Rapportage 27/07

Inhoud

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Is er voldoende voorraad om de huidige week in de vraag te kunnen voorzien? | ✓ |
| | • Handschoenen* | ✓ |
| 2. | Is er voldoende voorraad (incl. nog te keuren voorraad) om de huidige week in de vraag te kunnen voorzien? | ✓ |
| | • Handschoenen* | ✓ |
| 3. | Toelichting handschoenen | |
| 4. | Kan het LCH de volgende 10 weken voorzien in de vraag inclusief 2 ^e golf? | ✓ |
| | • Handschoenen** | ✓ |
| 5. | Wat heeft het LCH momenteel in aan de zorg uitgeleverd? | |
| 6. | Is er voldoende in de bestelling om aan de vraag te kunnen blijven voldoen? | ✓ |
| 7. | Leveringen en bestellingen IC apparatuur | |


* Op dit moment is er een tekort om in de weekvraag te voorzien, nadere toelichting op slide 4

** Op dit moment lijkt er vanuit de data over 5 weken een tekort aan handschoenen te ontstaan. Of dit tekort in handschoenen daadwerkelijk ontstaat is o.a. afhankelijk van het besluit dat genomen wordt over het goedkeuren voor levering van ruim 200 miljoen handschoenen die reeds binnen zijn. Daarnaast verwacht het LCH nog boekingen voor aankomst na week 35, waarmee de voorraad wordt aangevuld.

Met uitzondering van de handschoenen is de voorraad van het LCH voldoende om aan de weekvraag te voldoen.



Voorraadstand week 31(26-07) t.o.v. de gemiddelde weekvraag

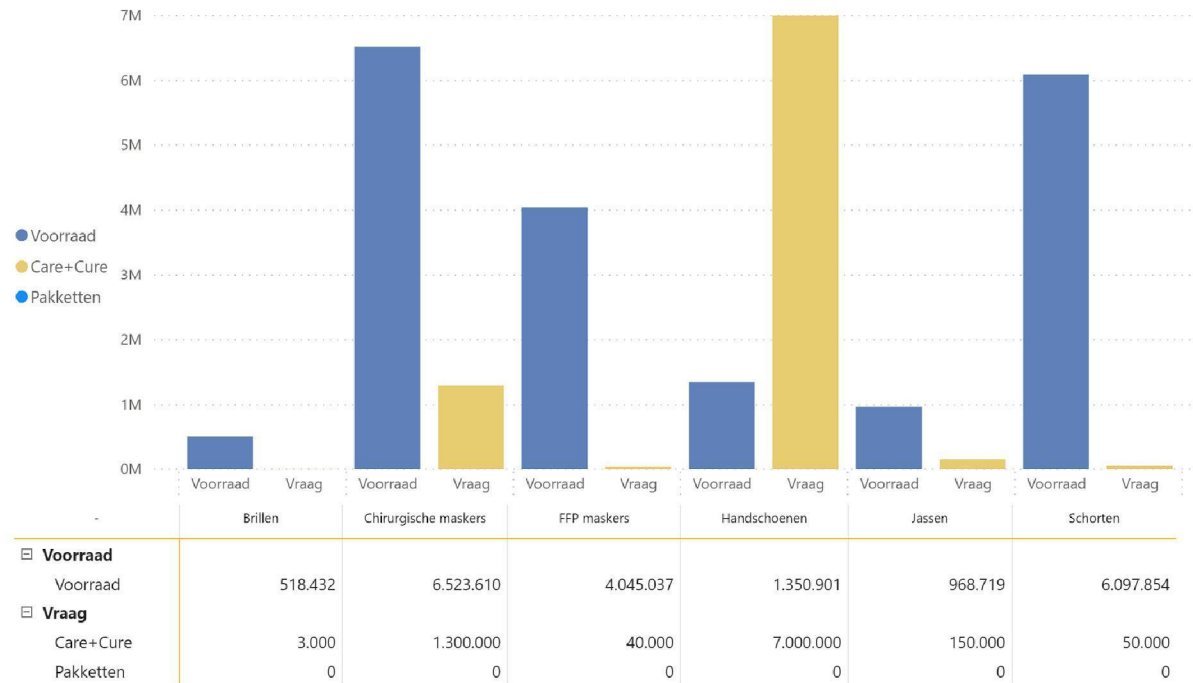

TOELICHTING


In deze grafiek zijn de leverbare voorraad en de vraag per productgroep weergegeven. Het LCH heeft voldoende medische hulpmiddelen op voorraad om in de gemiddelde weekvraag vanuit de gezondheidszorg te voorzien.

Handschoenen zie slide 4

Door de nog te keuren voorraad mee te nemen in voorgaande grafiek, wordt zichtbaar waar de artikelen die afgelopen weken aangekomen zijn zich in het proces bevinden.



Voorraadstand en voorraad TBD week 31(26-07) t.o.v. de gemiddelde weekvraag

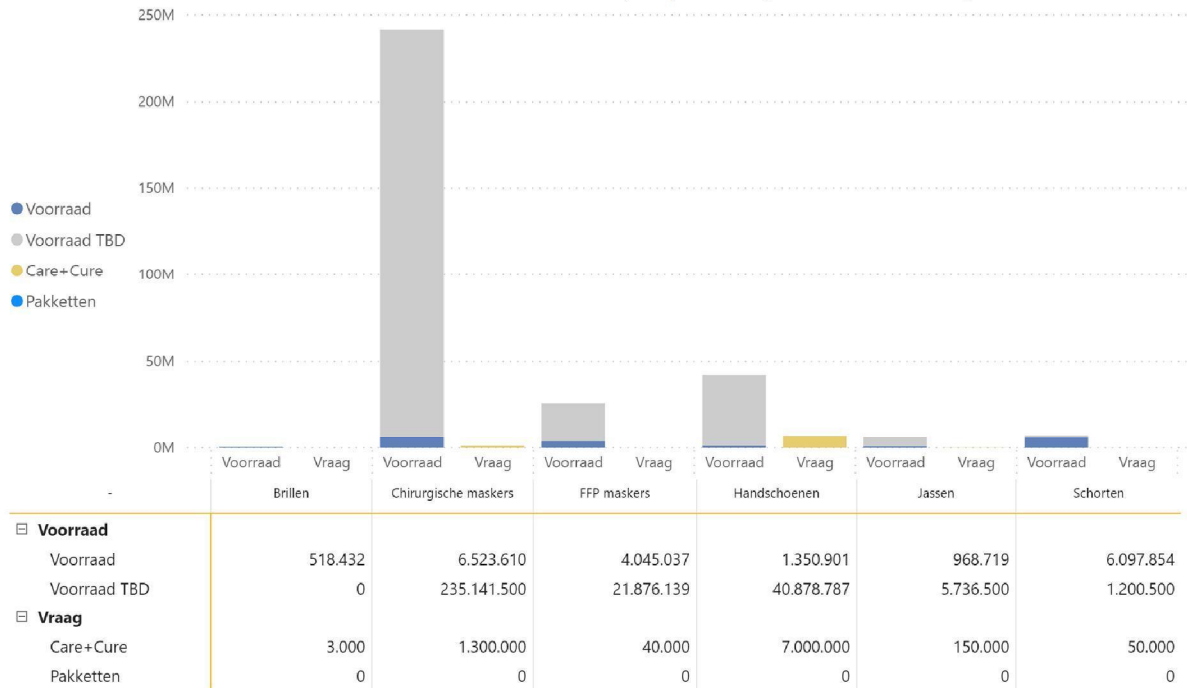

TOELICHTING

Op verzoek van VWS is in het lichtgrijs de voorraad TBD toegevoegd. Dit zijn goederen die zijn binnengekomen in Vianen maar die nog geen kwaliteitsoordeel hebben. Artikelen die vorige weken in 'aanvoer' stonden, komen in eerste instantie in deze categorie terecht voordat ze leverbare voorraad worden.

Vanwege het niet vrijgeven van een grote partij handschoenen, ontstaat er een tekort in de leverbare voorraad van het LCH



Voor handschoenen geldt dat het een productgroep is waaraan wereldwijd op dit moment een tekort is. Hierdoor staat al sinds de oprichting van het LCH de voorraadopbouw voor handschoenen onder druk. De verwachting was dat met de levering die in week 28 gepland stonden, het LCH direct (vanaf week 29) voldoende leverbare voorraad zou hebben om een langere periode (> 1 maand) in de vraag te kunnen voorzien. Komende weken staan meerdere grote leveringen gepland. Na aankomst en keuring blijkt echter dat deze levering niet direct in de leverbare voorraad kan worden opgenomen. De reden om de handschoenen nog niet vrij te geven is dat bij de kwaliteitstest door RIVM twee stoffen zijn aangetroffen die niet eerder zijn aangetroffen in voorgaande leveringen van handschoenen uit dezelfde fabriek. RIVM heeft dit in onderzoek aangezien men niet weet of de aangetroffen stoffen een gezondheidsrisico met zich mee kunnen brengen. Gedurende onderzoek staat de voorraad on hold.

Update 27/7:

In de afgelopen week is een partij handschoenen (niet zijnde de partij die hierboven staat beschreven) die 'on hold' stond vrijgegeven voor gebruik. Dit heeft geresulteerd in ophoging van vrije voorraad van in totaal 10 miljoen handschoenen in diverse maten. Hiermee is / wordt de voorraad aangevuld tot een stand waarin uitgeleverd kan worden naar normverbruik.

Daarnaast is vorige week het besluit genomen om de verkoopprijs van de handschoenen te verhogen naar 10 cent. Tot dit besluit verkocht het LCH de handschoenen onder marktprijs, de verwachting is dat met deze prijsverhoging het aantal bestellingen zal afnemen.

Mitigerende maatregelen



Logistiek is bezig handschoenen die momenteel klaar staan voor bootvracht vanuit Maleisië nog deze week om te zetten op het vliegtuig. Als deze handschoenen bij aankomst in Nederland goed door het keuringsproces komen, dan zullen zij direct aan de leverbare voorraad worden toegevoegd.

Update 27/7: Er is besloten om in het totaal ruim 8 miljoen handschoenen in te laten vliegen vanuit China. Naar verwachting vindt deze vlucht begin volgende week plaats.



Inkoop zoekt naar (alternatieve) leveranciers die op korte termijn de leverbare voorraad kunnen aanvullen. Deze partijen zullen worden ingevlogen.

Update 27/7: Vooral nog is er geen (betrouwbare) leverancier gevonden om op korte termijn een bestelling bij te kunnen doen. Voor de langere termijn (levering oktober) is er een partij gevonden die significante aantallen kan leveren. Besluit tot aankoop wordt deze week genomen.





Er wordt gezocht naar een onderzoeksinstelling die de resultaten van RIVM kan verifiëren. Reden is dat fabriek formeel aangeeft dat aangetroffen stoffen niet gebruikt worden in productieproces. Mogelijke meetfout dient dan ook uitgesloten te worden ivm mogelijke juridische vervolgstappen. Streven is in week 30 uitsluitsel.

Update 27/7: Zowel NoBo Eurofins als SGS is gevraagd om extra keuringen uit te voeren



Aanvoer en voorraad van LCH is voldoende om de komende 10 weken aan de vraag te voldoen, ook wanneer er een periode van piekverbruik is.



Het LCH is een voorraad op alle hulpmiddelen aan het creëren om aan de huidige vraag te voldoen en voor het geval er een tweede COVID-19 piek zou ontstaan. In onderstaande grafieken wordt de vraag voor de komende 10 weken (**blauwe lijn, in beide grafieken**) afgezet tegen de huidige voorraad aangevuld met de verwachte instroom (**oranje staafjes**). Van de aanvoer is het percentage waarvan we verwachten dat het niet in de beschikbare voorraad komt, reeds afgetrokken.

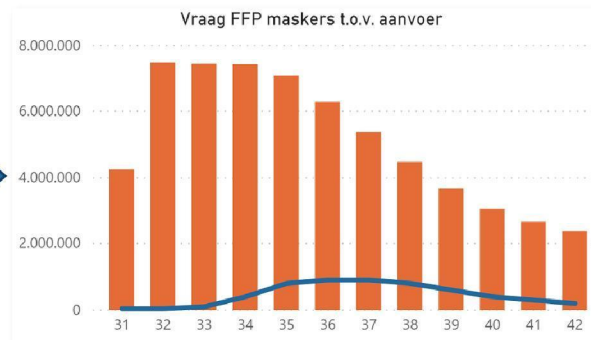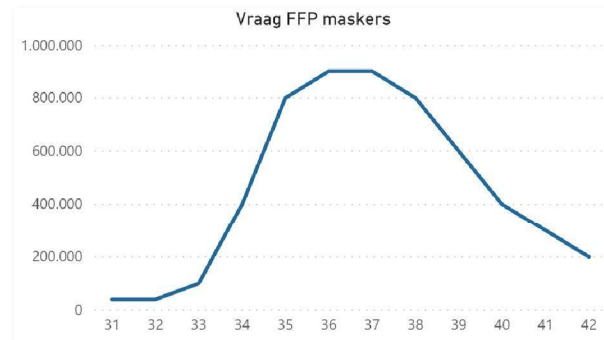


Interpretatie:
Met enkel de huidige voorraad FFP maskers, aangevuld met de maskers die geboekt zijn voor transport, heeft het LCH ook bij een tweede golf, uitgaande van het Accenture model (piek start minder abrupt, met langere afbouwperiode) voldoende voorraad om in de vraag te voorzien.

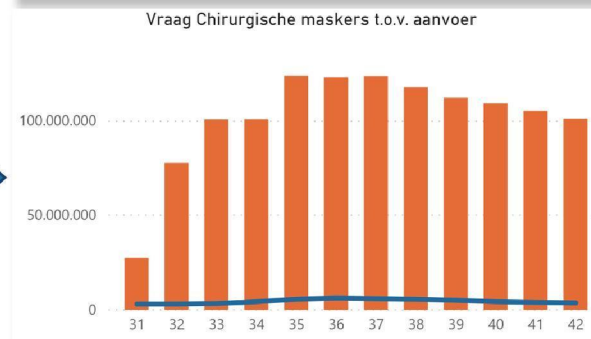
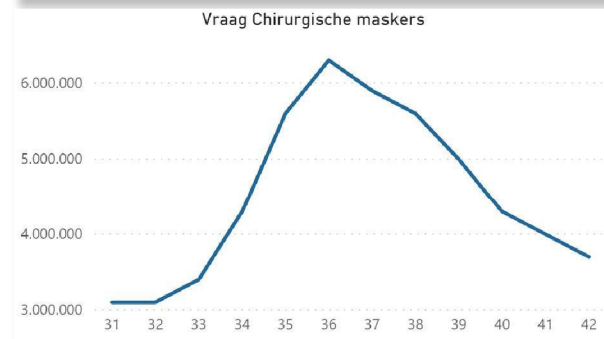


Interpretatie:
Met enkel de huidige voorraad Chirurgische maskers, aangevuld met de maskers die geboekt zijn voor transport, heeft het LCH ook bij een tweede golf, uitgaande van het Accenture model (piek start minder abrupt, met langere afbouwperiode) voldoende voorraad om in de vraag te voorzien.



Aanvoer en voorraad van LCH is voldoende om de komende 10 weken aan de vraag te voldoen, ook wanneer er een periode van piekverbruik is. (2)

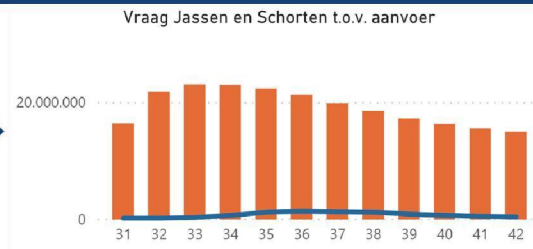

Interpretatie:
Met enkel de huidige voorraad Jassen en Schorten, aangevuld met de Jassen en Schorten die geboekt zijn voor transport heeft het LCH ook bij een tweede golf, uitgaande van het Accenture model voldoende voorraad om in de vraag te voorzien.

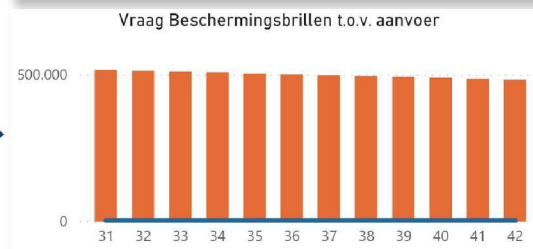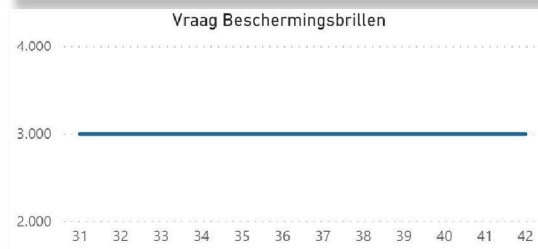


Interpretatie:
Uitgaande van enkel de huidige voorraad beschermingsbrillen, aangevuld met de beschermingsbrillen die al 'geboekt' staan op het schip heeft het LCH ook bij een tweede golf conform het model van Accenture voldoende voorraad om in de vraag te voorzien.

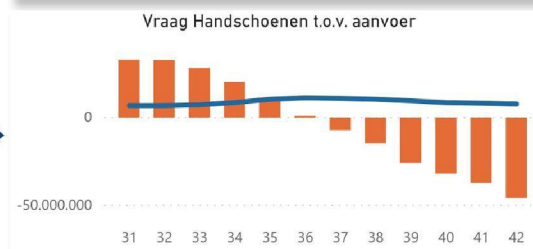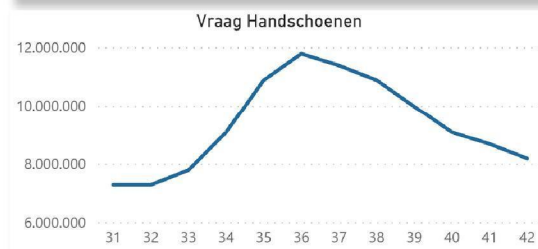

Interpretatie
Uitgaande van de vraag zoals voorspeld in het Accenture model ontstaat er over vijf weken een tekort aan leverbare handschoenen vanuit het LCH. Of dit tekort daadwerkelijk ontstaat is o.a. afhankelijk van het keuringsbesluit dat wordt genomen over de ruim 200 miljoen handschoenen die de afgelopen drie weken zijn binnen gekomen. Daarnaast verwacht het LCH nog boekingen voor aankomst na week 35, waarmee de voorraad wordt aangevuld

In week 30 zijn ruim 5.9 miljoen medische hulpmiddelen uitgeleverd door het LCH, waarvan 3.9 miljoen handschoenen.

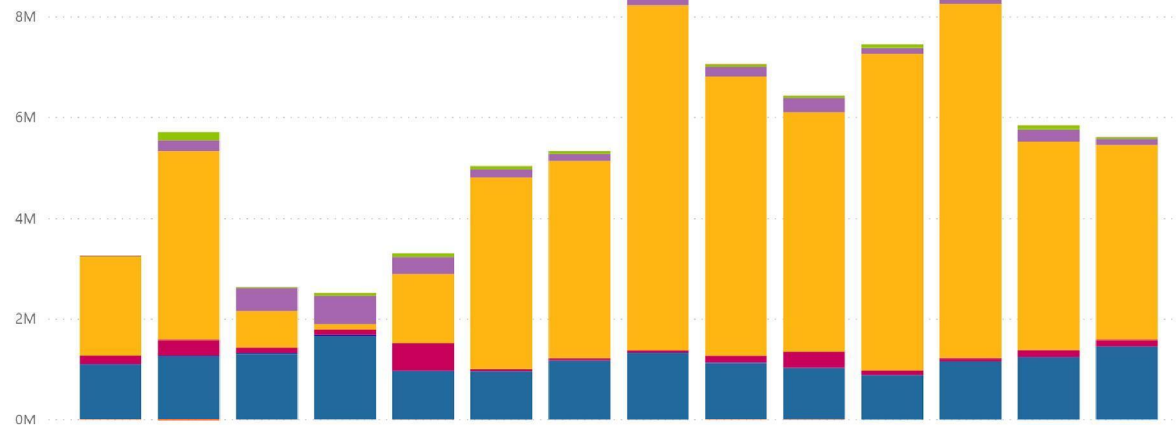

TOELICHTING
Het LCH heeft in week 30 ruim 5,9 miljoen persoonlijke beschermingsmiddelen uitgeleverd aan de gezondheidszorg, waarvan het grootste deel handschoenen. Dit is een lichte daling t.o.v. eerdere weken. Ruim de helft van de producten (66%) is uitgeleverd aan instellingen uit de care sector.

Product Categorie / Week	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Afnameset	3.700	100	4.700	10.950	1.600	1.000	4.150	1.450	800	6.900	5.750	5.900	7.800	18.250
Brillen	15.964	22.161	3.968	4.651	4.236	1.147	2.130	891	13.514	22.584	305	610	1.433	2.052
Chirurgische maskers	1.086.558	1.245.446	1.304.900	1.652.750	964.950	958.750	1.175.000	1.326.110	1.118.000	1.008.700	884.000	1.154.700	1.227.200	1.436.150
Desinfectant	14.802	16.446	16.303	19.714	11.232	10.894	8.122	11.876	8.930	4.776	9.810	8.970	16.623	10.234
FFP maskers	160.571	308.796	107.020	104.830	541.403	44.709	35.680	48.300	137.710	316.450	87.518	56.539	140.040	126.340
Handschoenen	1.943.450	3.738.229	723.021	110.400	1.366.620	3.799.300	3.914.100	6.839.600	5.547.900	4.744.500	6.286.600	7.031.700	4.124.800	3.865.900
Jassen	315	216.895	452.774	558.946	330.818	153.502	139.300	195.370	193.650	283.270	115.564	97.603	245.502	116.751
Schorten	0	158.800	20.500	49.310	89.100	65.700	50.600	19.550	42.200	35.900	69.300	42.500	80.200	29.400
Spatschermen	22.107	-19.970	1.200	4.200	2.600	1.600	2.947	3.265	7.920	1.010	2.320	7.440	4.720	4.090

Het aantal persoonlijke beschermingsmiddelen in bestelling is genoeg om de vraag vanuit de gezondheidszorg aan het LCH minstens een jaar aan te kunnen.



Artikelen (SKU)	In bestelling met ordernr.	Leverbare voorraad	Huidige weekvraag	Hoeveel weken kunnen we vooruit met wat in bestelling is gebaseerd op verwachte vraag komende week?	Hoeveel weken kunnen we vooruit met de voorraad gebaseerd op verwachte vraag komende week?
☐ Chirurgische maskers	860.325.454	6.523.610	1.300.000	662	5
Chirurgisch masker type 1	633.000				
Chirurgisch masker type 2	4.999.700				
Chirurgisch masker type 2R	854.692.754				
☐ Schorten	7.996.600	6.097.854	50.000	160	122
☐ FFP maskers	62.973.291	4.045.037	40.000	1.574	101
FFP1 Masker	74.380				
FFP2&3 Masker (FFP2, N95, KN95, FFP3)	62.898.911				
☐ Wattenstaafjes Keel	8.300.300	1.664.462	245.000	34	7
☐ Handschoenen	392.147.473	1.350.901	7.000.000	56	0
☐ Jassen	44.638.669	968.719	150.000	298	6
☐ Brillen	22.644	518.432	3.000	8	173
☐ Medium	1.302.791	502.735	245.000	5	2
☐ Wattenstaafjes Neus	5.711.910	126.625	245.000	23	1

TOELICHTING

In deze tabel is de vraag naar producten weergegeven (gebaseerd op de gemiddelde vraag via het portaal van de afgelopen 3 weken) t.o.v. het aantal bestelde producten. Hieruit blijkt dat het LCH wat betreft mondmaskers, beschermingsbrillen en handschoenen dermate hoge aantallen besteld heeft dat het LCH nog ruim een jaar in de vraag kan voorzien, wanneer de gemiddelde weekvraag op hetzelfde peil blijft als nu.

Leveringen en bestellingen IC apparatuur



Ontwikkelingen week 30

In week 30 zijn er geen nieuwe leveringen gearriveerd. Er zijn in week 29 van 2 verschillende leveranciers leveringen gearriveerd, namelijk Löwenstein en Geringe.

Van alle bestelde apparatuur uit China is alles afgeleverd. De Siriusmed beademingsapparaten bevinden zich nog in de test fase. Dräger, Hamilton en Geringe zijn de belangrijkste leveranciers, die met name reeds bekend zijn als leverancier van beademingsapparatuur in de Nederlandse ziekenhuizen. Zij komen de afspraken na en proberen zelfs om de leveringen aan NL te prioriteren t.o.v. andere landen.

In onderstaande grafiek is per categorie aangegeven hoeveel apparatuur er de afgelopen maanden is binnen gekomen. Op dit moment worden in meerdere ziekenhuizen testen gedaan. De testrapporten zijn nog niet allemaal gereed. De eerste testrapporten laten wel enkele aandachtspunten zien; deze zijn prima oplosbaar. Dit wordt in orde gemaakt zodat ook deze apparatuur gebruiksklaar is voor inzet in aanvullende flexibele opschaling.



Concluderend: In Nederland zijn er circa 3000 stuks IC beademingsapparatuur beschikbaar voor wanneer de (verwachte) implementatie van de opschalingsplannen gereed dient te zijn (huidige stand van uitleveringen + voorraad volwaardig high-end, Demcon en China).

Infuuspompen en spuitpomp

Naast de IC beademingsapparatuur zijn er tevens voor de flexibele opschaling infuus- en spuitpomp aangeschaft. Gezien de beperkte leveringsmogelijkheden van de A-leveranciers is er een order geplaatst bij een andere leverancier voor 1.810 pompen. Deze zijn vrijwel allemaal geleverd de laatste worden nu vervoerd vanuit China naar Nederland. Deze pompen worden reeds ingezet bij verschillende ziekenhuizen.