


LAMP-PCR

Over de test

De test meet:	Genetisch materiaal van het virus
Wijze van afname:	neus-keelwab door medisch geschoold personeel.
Verwerkingstijd:	1 uur
Analysesetting:	laboratoriumsetting, mobiel op locaties in te richten.

Beoogde uitrol:

Technische validatie:	afgerond
Klinische validatie:	in populatie die zich meldt bij GGD-teststraat, rapport wordt geschreven. Studie in mensen zonder klachten wordt voorbereid.
Implementatiestudie:	afgerond. Uitrol in grote teststraten wordt voorbereid.
Inkoop:	reagentia voor beoogde uitrol zijn in bestelling.
Risico's:	beschikbaarheid van reagentia en materialen, beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd medisch en lab personeel.

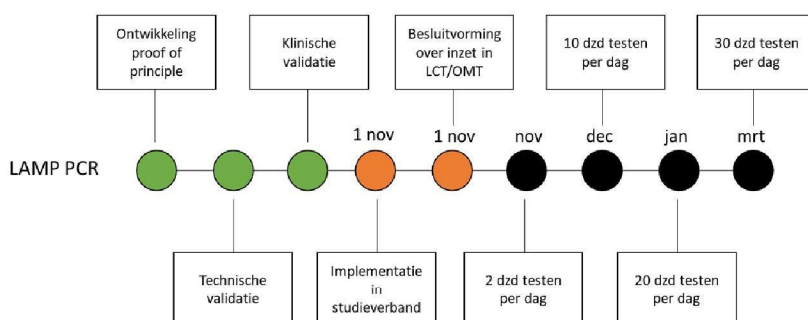

Ademtesten

Over de test

De test meet:	Vluchtige organische componenten
Wijze van afname:	Blaastest
Verwerkingstijd:	5 minuten
Analysesetting:	door geschoold personeel met gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen.

Beoogde uitrol:

Technische validatie:	afgerond
Klinische validatie:	Eerste studie op één type ademtest is afgerond. Een vervolgstudie wordt voorbereid. Openbare aanbesteding voor andere aanbieders van ademtesten is in voorbereiding.
Implementatiestudie:	Eerste implementatiestudie is afgerond.
Inkoop:	500 apparaten besteld die gefaseerd geleverd worden
Risico's:	validatie nog niet volledig afgerond, beschikbaarheid van de apparaten, beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.

